


解剖台近傍のホルムアルデヒド濃度

◆解剖台近傍濃度

平成19年 呼吸域帯75%の低減効果

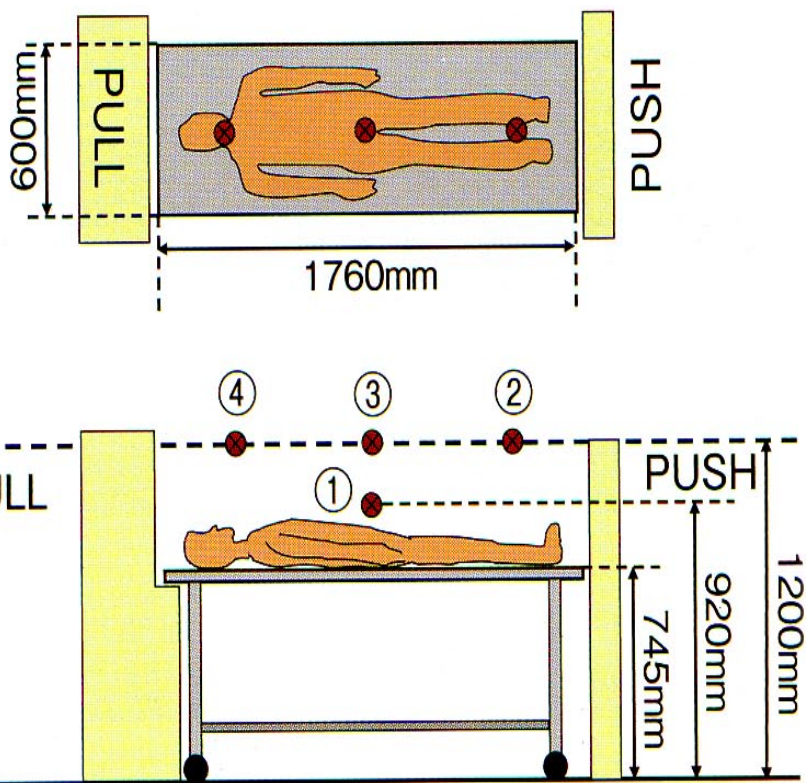

解剖台近傍の測定点

測定日 換気装置	10/29 OFF	11/30 OFF		11/12 ON
測定点	濃度 (ppm)	濃度 (ppm)		濃度 (ppm)
①	3.03	6.74	⇒	1.07
	3.06	5.12	⇒	1.77
	2.99	4.06	⇒	4.33
	Ave	3.03	5.31	
②	1.71	1.08	⇒	0.34
	1.82	1.38	⇒	0.34
	1.84	1.49	⇒	0.35
	Ave	1.79	1.32	
③	1.83	1.02	⇒	0.42
	1.93	1.51	⇒	0.40
	1.85	1.74	⇒	0.45
	Ave	1.87	1.42	
④	2.55	0.97	⇒	0.50
	2.58	1.35	⇒	0.47
	2.38	1.75	⇒	0.58
	Ave	2.50	1.35	

平成18年 呼吸域帯74%の低減効果

3.07→6.05
1.59→2.75

1.28→0.30
1.21→0.37

1.31→0.29
1.07→0.36

1.94→0.40
1.84→0.42

解剖台近傍ホルムアルデヒド濃度