


# 解剖準備室におけるホルムアルデヒド対策事例 — 抜脳作業に対するプッシュプル型換気装置の事例 —



# 解剖準備室の注入作業時近傍のホルムアルデヒド濃度

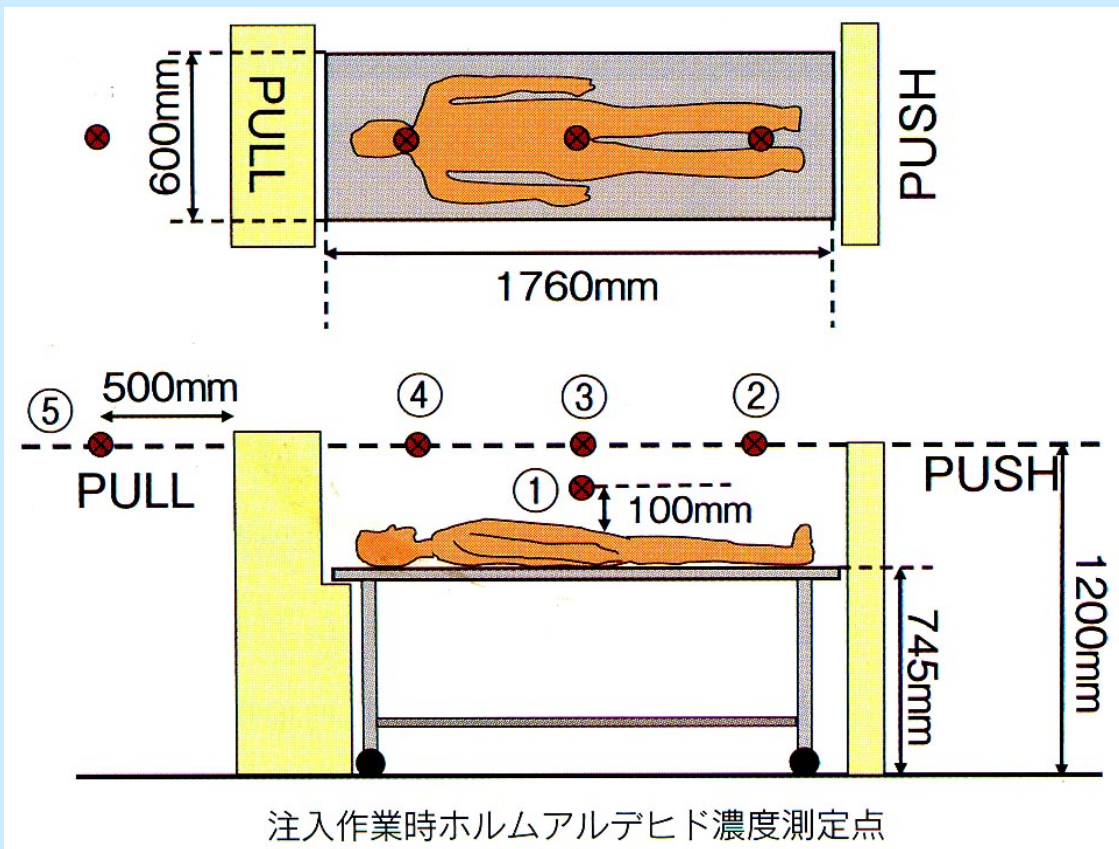

測定日 作業	3/7 注入		
	換気装置 OFF	ON	
測定点	濃度 (ppm)	濃度 (ppm)	
①	0.54	⇒ 0.04 0.03 0.08	
	②	0.30	⇒ 0.05 0.05 0.04
		③	0.33
④			0.28
	⑤		0.14

注入作業時ホルムアルデヒド濃度