

化審法における物理化学的性状・生分解性・生物濃縮性データ
の信頼性評価等について（案）

はじめに

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という。）の改正により、平成 22 年度に第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質を対象に優先評価化学物質を選定するための評価（以下「スクリーニング評価」という。）を行い、平成 23 年度以降に一般化学物質及び新規化学物質を対象に優先評価化学物質を選定するためのスクリーニング評価を開始し、引き続きリスク評価を実施する予定となっている。

ここでは、このスクリーニング評価及びリスク評価（一次）評価 I（以下、「スクリーニング評価等」という。）で利用する物理化学的性状・生分解性・生物濃縮性データ（以下「性状データ」という。）について、信頼性の評価とスクリーニング評価等で用いるデータ（キースタディ）の選定ルールについて規定する。

対象となる性状データは、融点、沸点、蒸気圧、水に対する溶解度、1-オクタノールと水との間の分配係数、大気・水域・底質又は土壤に係る分配係数（有機炭素補正土壤吸着係数、ヘンリー係数¹に限る。）、解離定数（酸解離定数に限る。）、生分解性、生物濃縮性に関するデータである。

これらの性状データの情報源は次の(ア)～(ウ)に大別される。

(ア) 化審法上のデータ²

(イ) 上記(ア)以外の文献情報等のデータ

(ウ) 適用範囲の推定方法（2.2 参照）による定量的データ（(ア)、(イ)を除く。）

スクリーニング評価等に必要なこれらの性状データの信頼性評価とそれらの中からのキースタディの選定は、審査・判定と同等に行なうことが理想的であるが、スクリーニング評価の一環として、多数の既存化学物質の性状データの信頼性評価やキースタディ選定を限られた時間内に効果的・効率的に審査・判定と同等に行なうことは難しいと考えられる。そこで、円滑な信頼性評価やキースタディ選定等を行うことを目的とし、これらの性状データの信頼性を確認する基準（以下、「信頼性基準」という。）、信頼性を付与した性状データがスクリーニング評価等に利用できるかどうかの判断基準（以下、「使用可否基準」という。）及びスクリーニング評価等で用いるキースタディを選定するルール（以下「キースタディ選定ルール」という。）（以下、この3つを併せ「選定基準」という。）をあらかじめ定め、

¹ ヘンリー係数：化学大辞典。ヘンリー定数、ヘンリー則定数と表現される場合もある。有害性情報の報告に関する省令（平成 16 年 3 月 18 日）に規定する蒸気圧及び水に対する溶解度より算出できる。

² 判定に用いられたデータ、国による試験データ、事業者より報告されたデータ

34 その選定基準に従って(ア)～(ウ)の性状データの中からスクリーニング評価等に使用する
35 性状データを選定することとする。また、優先評価化学物質の選定プロセスに科学的な客
36 観性と透明性を持たせるために、性状の項目別に使用可否基準とキースタディ選定ルール
37 を設定する。

38

39 1. 性状データに関する選定基準の考え方

40 1.1 信頼性ランクと使用可否基準

41 性状データの信頼性を、以下に示す、「信頼性あり（制限なし）（信頼性ランク1）」、「信
42 頼性あり（制限付き）（信頼性ランク2）」、「信頼性なし（信頼性ランク3）」、「評価不能（信
43 頼性ランク4）」の4つの信頼性ランクに分類する。

44 この信頼性ランクは、「OECD-HPV 化学物質点検マニュアル」での信頼性の考え方（参考
45 1）、「Japan チャレンジスポンサーマニュアル³」での信頼性ランク分類の目安（参考2）
46 を参考に整理したものであり、

47 (1) 国際的に、もしくは化審法上認められた試験法（推計法を含む）等によるデータであ
48 るか

49 (2) 専門家によりレビューされている、もしくはレビューされないとみなすことができ
50 るデータであるか

51 の2つの観点から分類している（表1）。

52

53 スクリーニング評価等には、信頼性ランクが付与された性状データのうち、信頼性ラン
54 ク「1」又は信頼性ランク「2」に該当する性状データを原則使用するものとする。

55 信頼性ランク「3」に該当する性状データは、使用しない。

56 信頼性ランク「4」に該当する性状データは、原則使用しない。

57 なお、信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ラン
58 ク「4」に該当する性状データを暫定的に使用することがある。

59

60 (参考) 信頼性ランク「4」に該当する性状データを、リスク評価（一次）評価II以降に
61 使用する場合には、精査等を行うこととする。

62

63 なお、ランクのより上位に該当するデータであっても、試験条件や結果の有効性が必ず
64 しも担保されていない場合もあり得る。性状データ選定に係る全体の流れ（図2）の中で
65 こうしたデータが確認された場合は使用しないと判断することもある。性状データごとの
66 使用可否基準については、「4. 性状の項目別の使用可否基準とキースタディ選定ルール」
67 の「使用可否基準」を参照。

68

³ 既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムスポンサーマニュアル（詳細版）

69 【信頼性ランク 1（信頼性あり（制限なし））】

- 70 • 化審法通知⁴の試験法、OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試
71 験法（参考 3）によるもので GLP 準拠のもの（信頼性ランク 1 A）。
- 72 • 化審法の判定結果を導くために直接的に使われたデータ及び OECD-HPV プログラムの
73 SIAR（SIDS Initial Assessment Report）で使用されたデータ（キースタディがあるものは
74 そのデータ、Reliability の記載があるものは信頼性ランク 1 及び 2 のデータを採用す
75 る。）（信頼性ランク 1 A）。
- 76 • 化審法通知の試験法、OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験
77 法（参考 3）によるもので GLP 準拠でないもの、または不明なもの（信頼性ランク 1 B）。
- 78 • 生分解性については、上記によらず、「4.9 生分解性」の使用可否基準を参照のこと。

79

80 【信頼性ランク 2（信頼性あり（制限付き））】

- 81 • OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験法（参考 3）と完全に
82 一致していないが、専門家により科学的に受け入れられると判断された試験法による
83 データ（信頼性ランク 2 A）。
- 84 • 「信頼性が高いと認められる情報源」（3 参照）に収録されている測定値データ（信頼
85 性ランク 2 B）。
- 86 • 適用範囲の推定方法（2.2 参照）による推定値（信頼性ランク 2 C）。

87

88 【信頼性ランク 3（信頼性なし）】

- 89 • 試験等に障害または不適切な箇所があり、専門家により容認できないと判断されたデ
90 ータ。

91

92 【信頼性ランク 4（評価不能）】

- 93 • 試験法及び情報源が不明なデータ。
- 94 • 試験法等の詳細が不明で、信頼性ランク 2 A か 3 かの判断ができないデータ。

95

96

97

⁴ 新規化学物質等の試験の方法について（平成 23 年 3 月 31 日薬食発 0331 第 7 号、平成 23・03・29 製局第 5 号、環保企発第 110331009 号）

98

表1 信頼性ランクと使用可否基準

| 使用可否基準 | 信頼性ランク | | 信頼性を評価する観点 | |
|--------|--------|------------|---|---|
| | | | 国際的に、もしくは化審法上認められた試験法等によるデータ | 専門家によりレビューされているとみなすことができるデータ |
| 原則使用可 | 信頼性あり | 1A 制限なし | 化審法又は OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験法（参考3）によるもので GLP 準拠のもの。 | 化審法の判定結果を導くために直接的に使われたデータ及び OECD / HPV プログラムの SIAR (SIDS Initial Assessment Report) で使用されたデータ（キースタディがあるものはそのデータ、Reliability の記載があるものは信頼性ランク 1 及び 2 のデータ）（ただし、分解性以外のデータ） |
| | | | 化審法又は OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験法（参考3）によるもので GLP 準拠でないもの又は、不明なもの。 | — |
| | | 2A 制限付き | — | OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験法（参考3）に準拠していないが、専門家により科学的に受け入れられると判断された試験法によるデータ。 |
| | | 2B | — | 「信頼性の定まった情報源」（3 参照）に収録されている測定値データ。 |
| | | 2C | 適用範囲の推定方法（2.2 参照）による推定値。 | 専門家が判断したカテゴリーアップローチによる推定値。 |
| 使用不可 | 信頼性なし | 3 | — | 試験等に障害又は不適切な箇所があり、専門家により容認できないと判断されたデータ。 |
| 原則使用不可 | 評価不能 | 4 | 試験法及び情報源が不明なデータ、又は試験法等の詳細が不明でランク 2A か 3 かの判断を行うことができないデータ。 | |

99

100 1.2 キースタディ選定ルール


101 スクリーニング評価等に使用する性状データは、信頼性ランク「1」又は「2」に該当するものの中から信頼性ランクの高いものから優先的に選択する（信頼性ランクの高いもの：1A>1B>2A>2B>2C）。最も高い信頼性ランクにデータが複数ある場合は、性状データごとに設定するキースタディ選定ルールによって決定する⁵（「4. 性状の項目別の使用可否基準とキースタディ選定ルール」の「キースタディ選択ルール」を参照）。

106

107 選定基準を使用してキースタディを選定する概念図は図1のとおり。詳細なフロー図に

⁵ 測定値が得られず、かつ、推定方法も適用できない場合の扱いについては、別途、化審法におけるリスク評価のガイダンスにおいて定める。

108 ついては「5. スクリーニング評価・リスク評価における性状データ選定の全体像」を参照
 109 のこと。また、リスク評価（一次）評価 I 終了以降では、専門家による総合的な観点から
 110 性状データについて精査を行った上で、精査を踏まえて必要に応じてキースタディの見直
 111 しを行う。

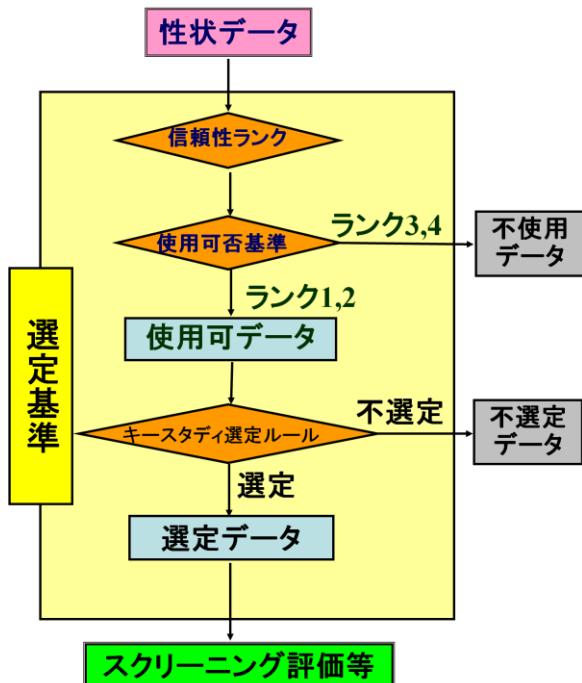

112
 113
 114 図1 物性データに関する概念的選定基準
 115
 116

2. 國際的に、もしくは化審法上認められた試験法等

2.1 試験法

化審法試験法通知の試験法、以下に示す OECD テストガイドライン及びそれに準じた試験法に従って測定された試験データは信頼性ランク「1」のデータと判断する。

OECD 等におけるテストガイドラインの改廃等に応じて適宜見直すこととする。

122

(1) 融点

- 124 ① OECD TG 102 (Melting Point/ Melting Rang)
- 125 ② JIS K 0064 (化学製品の融点及び溶融範囲測定方法)
- 126 ③ JIS K 0065 (化学製品の凝固点測定方法)
- 127 ④ ISO 1392 (Method for the determination of the crystallizing point)
- 128 ⑤ ISO 2207 (Petroleum waxes - Determination of congealing point)
- 129 ⑥ ISO 3016 (Petroleum oils - Determination of pour point)

130 ⑦ EPA OPPTS 830.7200 (Melting Point / Melting Range)

131

132 (2) 沸点

133 ① OECD TG 103 (Boiling point/boiling range)

134 ② JIS K 0066 (化学製品の蒸留試験方法)

135 ③ ISO 918 (Volatile organic liquids for industrial use – Determination of distillation
136 characteristics)

137 ④ ISO 3924 (Petroleum products – Determination of boiling range distribution – Gas
138 chromatography method)

139 ⑤ ISO 3405:1988 (Petroleum products – Determination of distillation characteristics)

140 ⑥ EPA OPPTS 830.7220 (Boiling Point / Boiling Range)

141

142 (3) 蒸気圧

143 ① OECD TG 104 (Vapour Pressure Curve)

144 ② JIS K 2258-1 (原油及び石油製品－蒸気圧の求め方－第1部：リード法)

145 ③ JIS K 2258-2 (原油及び石油製品－蒸気圧の求め方－第2部：3回膨張法)

146 ④ ISO 3007 (Petroleum products and crude petroleum – Determination of vapor pressure –
147 Reid method)

148 ⑤ EPA OPPTS 830.7950 (Vapor Pressure)

149

150 (4) 水に対する溶解度

151 ① OECD TG 105 (Water Solubility)

152 ② EPA OPPTS 830.7840 (Water Solubility)

153 ③ EPA OPPTS 830.7860 (Water Solubility Generator Column Method)

154

155 (5) 有機炭素補正土壤吸着係数

156 ① OECD TG 121 (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage
157 Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC))

158 ② OECD TG 106 (Adsorption -Desorption Using a Batch Equilibrium Method)

159 ③ EPA OPPTS 835.1110 (Activated Sludge Sorption Isotherm)

160 ④ EPA OPPTS 835.1220 (Sediment and Soil Adsorption / Desorption Isotherm)

161 ⑤ ISO 18747 (Water quality: adsorption of substances on activated sludge-batch test using
162 specific analytical method.)

163

164 (6) 解離定数(酸解離定数)

165 OECD TG 112 (Dissociation Constants in Water)

166

167 (7) 1-オクタノールと水との間の分配係数

- 168 ① OECD TG 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method)
 169 ② OECD TG 117 (Partition Coefficient (n-octanol/water), High Performance Liquid
 170 Chromatography (HPLC) Method)
 171 ③ OECD TG 123 (Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method)
 172 ④ JIS Z 7260-107 (分配係数 (1-オクタノール/水) の測定—フ拉斯コ振とう法)
 173 ⑤ JIS Z 7260-117 (分配係数 (1-オクタノール/水) の測定—高速液体クロマトグラフィー)
 174 ⑥ EPA OPPTS 830.7550 (Partition Coefficient (n-Octanol/Water), Shake Flask Method)
 175 ⑦ EPA OPPTS 830.7560 (Partition Coefficient (n-Octanol/Water), Generator ColumnMethod)
 176 ⑧ EPA OPPTS 830.7570 (Partition Coefficient (n-Octanol/Water), Estimation By Liquid
 177 Chromatography)

178

179 (8) 生分解性

- 180 ① OECD TG 301A (DOC Die-Away)
 181 ② OECD TG 301 B (CO₂ Evolution (Modified Sturm Test))
 182 ③ OECD TG 301C (MITI (I) (Ministry of International Trade and Industry, Japan))
 183 ④ OECD TG 301D (Closed Bottle)
 184 ⑤ OECD TG 301E (Modified OECD Screening)
 185 ⑥ OECD TG 301F (Manometric Respirometry)
 186 ⑦ OECD TG 310 (Ready Biodegradability – CO₂ in sealed vessels (Headspace Test))

187

188 (9) 生物濃縮性⁶

- 189 ① OECD TG 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)
 190 ② OECD TG 305 A (Bioaccumulation: Sequential Static Fish Test)
 191 ③ OECD TG 305 B (Bioaccumulation: Semi-static Fish Test)
 192 ④ OECD TG 305 C (Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish)
 193 ⑤ OECD TG 305 D (Bioaccumulation: Static Fish Test)
 194 ⑥ OECD TG 305 E (Bioaccumulation: Flow-through Fish Test)
 195 ⑦ JIS Z 7260-305 (生物濃縮 (水からの直接濃縮) : 魚類を用いる連続流水式試験方法)
 196 ⑧ EPA OPPTS 850.1730 (Fish BioconcentrationTest)

197

198 2.2 推定方法

199 「OECD-HPV 化学物質点検マニュアル」において、SIDS 項目に対して推定値の使用を認
 200 めており、本選定基準においても、適用範囲の推定方法による推定値を、信頼性ランク「2

⁶ OECD TG 305 A～E は、1996 年に OECD TG 305 に統合された。

201 C」のデータ（入力データが信頼性ランク「2B」以上の場合に限る。）として補完すること
 202 とする。なお、推定するために用いたデータが、信頼性ランク「2C」以下の場合、得られ
 203 る推定値は、信頼性ランク「4」（信頼性不明）とする⁷。

204 スクリーニング評価等において性状データの補完に用いる推定方法及び適用範囲を表2
 205 に示す。

206

207 表2 スクリーニング評価等においてデータ補完に用いる推定方法

| 項目 | 推定方法 | 推定に必要な項目 | 適用範囲 |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|
| 融点 | MPBPWIN (EPI Suite) | SMILES 又は CAS 番号 | 無機・金属・有機金属化合物、分子量が1000を超える物質、反応性・加水分解性物質、1・2族の陽イオン塩化合物以外の物質 ^{※7} |
| 沸点 | MPBPWIN (EPI Suite) | SMILES 又は CAS 番号 | |
| 蒸気圧 | MPBPWIN (EPI Suite) | SMILES 又は CAS 番号、融点、沸点 | |
| 水に対する溶解度 | WSKOWWIN (EPI Suite) ^{※1} | SMILES 又は CAS 番号、Log Pow、融点、MW | |
| 有機炭素補正土壤吸着係数 (Koc) | KOCWIN (EPI Suite) ^{※2} | SMILES 又は CAS 番号、Log Pow | |
| 1-オクタノールと水との間の分配係数 (log Pow) | KOWWIN (EPI Suite) | SMILES 又は CAS 番号 | |
| 生物濃縮係数 (BCF) | BCFBFWIN (EPI Suite) ^{※3} | SMILES 又は CAS 番号、Log Pow | 同上、4.10 参照 |
| | 濃縮性予測システム(CERI モデル) ^{※4} | SMILES 又は CAS 番号、Log Pow | 有機物質一般全般。ただし、logPow が 7 以上の物質、珪素化合物及び金属化合物は適用外 |
| | BCF base-line model(OASIS Catalogic) ^{※5} | SMILES 又は CAS 番号、Log Pow | 有機化合物全般（無機化合物や高分子化合物を除く）。但し、以下の3種類のドメインの領域内の物質が精度良く予測できる物質とされている。 ①パラメータドメイン：logPow、分子量、対水溶解度がトレーニングセットの範囲内。 ②構造ドメイン：トレーニングセットに含まれている部分構造のみから成る化学構造を持つ物質。 ③メカニズムドメイン：受動拡散が仮定できる物質。 |
| | 回帰式 (4.10 参照) | Log Pow | 4.10 参照 |
| ヘンリー係数 | HENRYWIN (EPI Suite) ^{※6} | SMILES 又は CAS 番号 | 水に対する溶解度 ≥ 1 mol/L (4.6 参照) ^{※8} |

⁷ ただし、推定方法において入力値に推計値を前提としている場合は「2C」とする。具体的には4.10の(式2)の場合。

| | 計算式 $H=VP/(WS/MW)$ | 分子量、水に対する溶解度、蒸気圧 | 水に対する溶解度<1 mol/L (4.6 参照) |
|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 解離定数（酸解離定数）(pKa) | SPARC | SMILES | 有機化合物 ^{※9} |

208 ※1：トレーニングセットの適用範囲：分子量 (MW) =27～628、Log Pow=-3.9～8.3
 209 ※2：トレーニングセットの適用範囲：分子量 (MW) =32～665、Log Koc=約 0～約 7
 210 ※3：トレーニングセットの適用範囲：分子量 (MW) =68～959、Log Pow=-1.4～11.3
 211 ※4：トレーニングセットの適用範囲：記載なし
 212 ※5：トレーニングセットの適用範囲：分子量 (MW) =MW=16.0416～943.2202、logPow=-4.0484～16.0739
 213 ※6：トレーニングセットの適用範囲：分子量 (MW) =26～451
 214 ※7：OECD のサイト (<http://webdominol.oecd.org/comnet/env/models.nsf> ; 2009 年 6 月 6 日アクセス) から引用 (2011 年 3 月 3 日現在不通)
 215 ※8：トレーニングセットに含まれる結合を持つ化合物のみ推定値が出力される
 216 ※9：EPA のサイト (http://www.epa.gov/athens/publications/reports/EPA_600_R_03_033.pdf; 2011 年 3 月 3 日アクセス) から引用、トレーニングセットの適用範囲：pKa=約-12～約18
 217
 218
 219
 220
 221 Estimation Program Interface (EPI) Suite は、米国環境保護庁（以下、「U.S. EPA」）という。と Syracuse Research Corporation が共同開発した物理化学的性状と環境中運命評価モデルに関するソフトウェアであり、融点、沸点、蒸気圧などの各項目に関する構造活性相関等による推計モデルの集合体である。SMILES 形式の構造式又は CAS 番号を入力することによって、推定値を計算する。
 222 SPARC は、SPARC Performs Automated Reasoning in Chemistry のことで、米国ジョージア大学の L.A. Carreira 教授らがインターネット上に構築している化学構造-物性計算ソフトウェアであり、pKa などの物理化学的性状を推算する機能を備えている。KOWWIN や ClogP が置換基の寄与率を加算して特性値を算出するのに対し、SPARC は基本的な化学構造のアルゴリズム（科学的な熱力学原理にもとづいたメカニズムモデル）を基盤とする一般的な方法である。なお、SPARC では SMILES を用いて構造情報を入力する必要がある。
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233 3. 信頼性の定まった情報源
 234 本選定基準では、3.1 から 3.3 に掲げる情報源を信頼性の定まった情報源として扱う。信
 235 頼性の定まった情報源は、必要に応じ柔軟に見直しを行う。
 236
 237 3.1 信頼性が高いと認められる情報源
 238 「Japan チャレンジスポンサーマニュアル」での信頼性ランク分類の目安（参考 2）にお
 239 いて、信頼性が高いと認められる情報源に収録されているデータの使用を認めている。本
 240 選定基準においても、「Japan チャレンジスポンサーマニュアル」、「OECD- HPV 化学物質

241 点検マニュアル」、「REACH の技術ガイダンス」に取り上げられており、ピアレビューがな
 242 されていると考えられる次の情報源の測定値データについては、原則として原著等での確
 243 認を要さず⁸信頼性ありと判断する。

244 以下に掲げる情報源のうち、OECD の SIDS (Screening Information Data Set)において SIAR
 245 に使用されたデータは信頼性ランク「1 A」に分類される。その他の情報源は、表 1 に示
 246 す基準では、信頼性ランク「2 B」と判断されるが、2.1 に記載した試験法にて実施された
 247 ことが確認できれば、原則信頼性ランク「1」に分類される。

248

- 249 • OECD : SIDS レポート
- 250 • CRC Handbook of Chemistry and Physics, 90th, CRC-Press, 2009
- 251 • Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
- 252 • Hawley's Condensed Chemical Dictionary, 15th, John Wiley & Sons, 2007
- 253 • SRC PhysProp Database, Syracuse Research Corporation, 2009
- 254 • The Merck Index, 14th Ed, Merck & Co, 2006
- 255 • The IUPAC Solubility Data Series
- 256 • Illustrated Handbooks of Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for Organic
 257 Chemicals, CRC-Press, 1997
- 258 • Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, 2005

259

260 3.2 専門家によるレビューを経ている情報源

261 原則として、次の情報源の測定値データ（キースタディがあるものはそのデータ、
 262 Reliability の記載があるものは信頼性ランク「1」及び「2」のデータ）については、専門
 263 家によるレビューを経ている等の作成経緯を考慮して原著等での確認を要さず原則として
 264 信頼性ありと判断する。

265 表 1 に示す基準では、信頼性ランク「2 B」と判断されが、2.1 に記載した試験法にて実
 266 施されたことが確認できれば、原則信頼性ランク「1」に分類される。

267 キースタディ、Reliability 1 又は Reliability 2 のデータが 2 つ以上ある場合は、優先順位は
 268 キースタディ > Reliability 1 > Reliability 2 とする。

269

- 270 • US／HPV チャレンジプログラム
- 271 • Japan チャレンジプログラム
- 272 • (独)製品評価技術基盤機構：「化学物質の初期リスク評価書」・(財)化学物質評価研究機
 273 構・(独)製品評価技術基盤機構：「化学物質有害性評価書」
- 274 • 環境省環境リスク評価室：「化学物質の環境リスク評価」

⁸ 「OECD-HPV マニュアル」や「REACH の技術ガイダンス」では、HSDB 及び SRC PhysProp Database については、原著等での確認を要するとの記載がある。

- 275 ・ WHO/IPCS :「環境保健クライテリア (EHC)」
276 ・ WHO/IPCS :「国際簡潔評価文書 (CICAD)」
277 ・ ATSDR (米国毒性物質疾病登録局) :「Toxicological Profile」
278 ・ EU ECB (European Chemicals Bureau) :「リスク評価書 (EU Risk Assessment Report)」

279

280 (参考) これらの情報源から得られた性状データを、リスク評価（一次）評価Ⅱ以降に使
281 用する場合には、精査等を行うこととする。

282

283 3.3 専門家が信頼性ありと認めた情報源

284 専門家が信頼性ありと認めた次の情報源の測定値データについては原著等での確認を要
285 さず信頼性ありと判断する。

286 表 1 の基準では、信頼性ランク「2B」と判断される。

287

- 288 ・ Sigma-Aldrich 試薬カタログ

289

290 (参考) この情報源から得られた性状データを、リスク評価（一次）評価Ⅱ以降に使用す
291 る場合には、精査等を行うこととする。

292

293 4. 性状の項目別の使用可否基準とキースタディ選定ルール

294 4.1 融点

295 使用可否基準

296 表 1 の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。

297 融点のデータが得られない場合、凝固点のデータを選択することができる。この場合、
298 その旨を明示する。得られたデータが溶融範囲又は凝固範囲である場合は、その範囲の平
299 均値を融点又は凝固点として扱う。

300 なお、融点又は凝固点が得られない場合であっても、軟化点/流動点、分解点、及び昇華
301 点が得られる場合には、専門家判断により代替することができる。この場合、その旨を明
302 示する。

303 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
304 のデータを暫定的に使用する。

305

306 キースタディ選定ルール

307 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。

- 308 ① 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性が高いデータが 1 つであれば、
309 それを採用する。
- 310 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合は、その算術平均値を求め、算

311 術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±10°C以内⁹である場合は算術平均値に
 312 最も近い測定値を選定する。算術平均値±10°Cを超えるデータがある場合は、そのデ
 313 データを除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選定する。
 314 なお、データが2つの場合においてはキースタディを1つに絞り込むことはできない。
 315 この場合には、2つのデータをキースタディとし、化学物質の融点としては2つのデ
 316 データの算術平均値を採用する。

- 317 ③ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合は、②と同様に選定する。
 318 ④ MPBPWIN（EPI Suite）による融点の推定値を選定する。

319

320 4.2 沸点

321 **使用可否基準**

322 表1の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。
 323 得られたデータが沸点範囲である場合は、その範囲の平均値を沸点として扱う。
 324 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
 325 のデータを暫定的に使用する。

326

327 **キースタディ選定ルール**

328 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。
 329 得られた沸点データが標準圧力以外の場合には、次に示す式で圧力補正を行い、標準圧
 330 力（101.3 kPa）における値に換算する¹⁰。

$$331 \quad BP' = BP + 0.00090 \times (273 + BP) \times \left(101.3 - \frac{P}{1000}\right)$$

- 332 ① 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性が高いデータが1つであれば、
 333 それを採用する。
 334 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合、圧力記載のデータを優先し、
 335 以下のように選定する。
 336 a. 圧力記載のデータが1つである場合：当該データを採用する。
 337 b. 圧力記載のデータが複数ある場合：その算術平均値を求め、算術平均値の算出に
 338 用いた各データが算術平均値±12.5°C以内¹¹である場合は算術平均値に最も近い
 339 測定値を選定する（算術平均値±12.5°Cを超えるデータがある場合は、そのデ
 340 タを除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選定す
 341 る。なお、データが2つの場合においてはキースタディを1つに絞り込むことは

⁹ REACHの技術ガイダンスでの測定値の推定精度±2.0Kを参考に設定。

¹⁰ JIS K0066 化学製品の蒸留試験方法 5.3 留出温度の大気圧補正式から引用、BPは補正前沸点(°C)、BP'は補正後沸点(°C)、Pは圧力(Pa)。

¹¹ REACHの技術ガイダンスでの測定値の推定精度±2.5Kを参考に設定。

342 できない。この場合には、2つのデータをキースタディとし、化学物質の沸点とし
343 ては2つのデータの算術平均値を採用する。

344 c. 圧力記載のないデータが複数ある場合：bと同様に選定する。

345 ③ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合は、②と同様に選定する。

346 ④ MPBPWIN (EPI Suite) による沸点の推定値を選定する。

347

348 4.3 蒸気圧

349 使用可否基準

350 表1の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。

351 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
352 のデータを暫定的に使用する。

353

354 キースタディ選定ルール

355 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。

356 温度記載のある蒸気圧は、20°Cにおける値に換算する。温度補正は次に示す式を用いる¹²。

$$VP' = VP \times e^{\left\{ \frac{H_{0vapor}}{R} \times \left(\frac{1}{T+273} - \frac{1}{20+273} \right) \right\}}$$

357

358

359 ① 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性が高いデータが1つであれば、
360 それを採用する。

361 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合、20~25°Cにおけるデータを優
362 先し、以下のように選定する。

363 a. 20~25°Cにおけるデータが1つである場合：当該データを採用する。

364 b. 20~25°Cにおけるデータが複数ある場合：その算術平均値を求め、算術平均値の
365 算出に用いた各データが算術平均値±50%以内¹³である場合は算術平均値に最も近
366 い測定値を選定する。算術平均値±50%を超えるデータがある場合は、そのデータ
367 を除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選定する。
368 なお、データが2つの場合においてはキースタディを1つに絞り込むことはでき
369 ない。この場合には、2つのデータをキースタディとし、化学物質の蒸気圧として
370 は2つのデータの算術平均値を採用する。

371 c. 20~25°C以外のデータが複数ある場合： 20~25°Cに温度が近いデータを採用する。

¹² ECB (2003) Technical Guidance Document on Risk Assessment. Part C, Chapter 3, 2.3.2 Data for exposure models の Equation (2)から引用、VPは補正前蒸気圧 (Pa)、VP'は補正後蒸気圧 (Pa)、Tは温度 (K)、Rは気体定数 (8.314 Pa·m³/(mol·K))、H_{0vapor}は蒸発エンタルピー (5×10⁴J/mol)。

¹³ REACH の技術ガイダンスでの測定値の再現精度が最大 50%であることを基づき設定。

- 372 d. 温度記載のないデータが複数ある場合： b と同様に選定する。
 373 ③ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合は、②と同様に選定する。
 374 ④ MPBPWIN (EPI Suite) による蒸気圧の推定値を選定する。このとき、キースタディ選定
 375 ルールに基づき決定された融点と沸点の値（測定値）を用いる。

$$VP' = VP \times e^{\left\{ \frac{H_{0vapor}}{R} \times \left(\frac{1}{T+273} - \frac{1}{20+273} \right) \right\}}$$

- 376
- 377 **4.4 水に対する溶解度**
- 378 **使用可否基準**
- 379 表 1 の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。
 380 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
 381 のデータを暫定的に使用する。
- 382

- 383 **キースタディ選定ルール**
- 384 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。
 385 温度記載のある値は 20°C の値に換算する。温度補正是次に示す式で行う¹⁴。

$$WS' = WS \times e^{\left\{ \frac{H_{0solut}}{R} \times \left(\frac{1}{T+273} - \frac{1}{20+273} \right) \right\}}$$

- 386
- 387 「不溶」等の定性的データの定量的データへの変換は行わないが、「不溶」と記載されて
 388 いるデータしか得られない場合は、測定方法の検出限界値の記載がある場合に限り、検出
 389 限界値を水に対する溶解度として選定する。この場合、その旨を明示する。
- 390
- 391 ① 信頼性ランク「1」又は「2」で最も信頼性が高いデータが 1 つであれば、それを採
 392 用する。
- 393 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合は、20~25°Cにおける値を優先
 394 し、以下のように選定する。
- 395 a. 20~25°Cにおけるデータが 1 つである場合：当該データを採用する。
- 396 b. 20~25°Cにおけるデータが複数ある場合：その算術平均値を求め、算術平均値の
 397 算出に用いた各データが算術平均値±30%以内¹⁵である場合は算術平均値に最も近
 398 い測定値を選定する。算術平均値±30%を超えるデータがある場合は、そのデータ
 399 を除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選定する。

¹⁴ ECB (2003) Technical Guidance Document on Risk Assessment. Part II, Chapter 3, 2.3.2 Data for exposure models の式(3)から引用、WS は補正前水溶解度 (mg/L)、WS' は補正後水溶解度 (mg/L)、T は温度 (K)、R は気体定数=8.314 [Pa·m³/(mol·K)]、H_{0solut} は溶解エンタルピー=1×10⁴ (J/mol)。

¹⁵ REACH の技術ガイダンスでの測定値の併行精度が最大 30% あることをに基づき設定。

400 なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1 つに絞り込むことはでき
 401 ない。この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学物質の水に対する溶
 402 解度としては 2 つのデータの算術平均値を採用する。

403 c. 20～25°C以外のデータが複数ある場合： 20～25°Cに温度が近いデータを採用する。

404 d. 温度記載のないデータが複数ある場合： b と同様に選定する。

405 ③ 信頼性ランク「2」のデータが複数ある場合、②と同様に選定する。

406 ④ WSKOWWIN (EPI Suite) による水に対する溶解度の推定値を選定する。このとき、キー
 407 スタディ選定ルールに基づき決定された log Pow 及び融点の値（測定値）を用いる。

408

409 4.5 有機炭素補正土壤吸着係数 (Koc)

410 使用可否基準

411 表 1 の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。

412 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
 413 のデータを暫定的に使用する。

414

415 キースタディ選定ルール

416 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。

417 ① 信頼性ランク「1」に該当するデータが 1 つであれば、それを採用する。

418 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合は、その算術平均値、その値に
 419 最も近い測定値を選定する。なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1
 420 つに絞り込むことはできない。この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学
 421 物質の Koc としては 2 つのデータの算術平均値を採用する。

422 ③ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合は、②と同様に選定する。

423 ④ KOCWIN (EPI Suite) による Koc の推定値を選定する。このとき、キースタディ選定
 424 ルールに基づき決定された log Pow の値（ただし測定値に限る。すなわち「2C」のデータ
 425 を除く。）を用いる。

426

427 4.6 ヘンリー定数

428 使用可否基準

429 表 1 の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。

430 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
 431 のデータを暫定的に使用する。

432

433 キースタディ選定ルール

434 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。

435 ① 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性が高いデータが 1 つであれば、

- 436 それを選定する。
- 437 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合は、その算術平均値を求め、そ
438 の値に最も近い測定値を選定する。なお、データが2つの場合においてはキースタディ
439 を1つに絞り込むことはできない。この場合には、2つのデータをキースタディとし、
440 化学物質のヘンリー定数としては2つのデータの算術平均値を採用する。
- 441 ③ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合は、②と同様に選定する。
- 442 ④ 推定によるヘンリー定数を選定する。
- 443 • キースタディ選定ルールに基づき決定された水に対する溶解度の値が「1 mol/L」未満
444 の場合は、次の計算式¹⁶によるヘンリー定数を選定する。
- 445

H=VP/(WS/MW)

- 446 このとき、キースタディ選定ルールに基づき決定された水に対する溶解度(WS)及び
447 蒸気圧(VP)の値(ただし測定値に限る。すなわち「2C」のデータを除く。)を用いる。
448 • キースタディ選定ルールに基づき決定された水に対する溶解度が「1 mol/L」以上の場
449 合は、HENRYWIN(EPI Suite)によるヘンリーコ系の推定値¹⁷を選定する。

4.7 解離定数(酸解離定数)(pKa)

使用可否基準

450 表1の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。

451 酸解離定数に関しては、水溶媒中におけるデータを使用し、水溶媒中以外のデータは使
452 用不可とする。

キースタディ選定ルール

453 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。

- 454 ① 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性が高いデータが1つであれば、
455 それを選定する。
- 456 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合は、その算術平均値を求め、算

¹⁶ William M. Meylan and Philip H. Howard (1991) Bond Contribution Method for Estimating Henry's Law Constants, Environmental Toxicology and Chemistry, 10, pp1283-1293, H(ヘンリーリー則定数; Pa·m³/mol)、VP(蒸気圧; Pa)、WS(水溶解度; mg/L)、MW(分子量)。

¹⁷ HENRYWINでは、化合物の結合の種類と数によるBond Contribution Method、化合物の置換基の数と種類によるGroup Contribution Method及び構造が似ているHenry則定数既知化合物のBond Contribution Methodを組み合わせたExperimental Value Adjusted Methodが実装されているが、より精度が高いと考えられるBond Contribution Methodの値を用いる。なお、計算式(H=VP/(WS/MW))は水溶解度が高い物質の場合、ヘンリーリー則定数が低く見積もられ、他の手法を用いるのが良いとされている。HENRYWINの開発者は水溶解度が1mol/L未満の化学物質には計算式(H=VP/(WS/MW))を推奨するとしている。

465 術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±1.0 以内¹⁸である場合は算術平均値に
 466 最も近い測定値を選定する。算術平均値±1.0 を超えるデータがある場合は、そのデータを除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選定する。
 467 なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1 つに絞り込むことはできない。
 468 この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学物質の pKa としては 2 つのデータの算術平均値を選定する。

- 471 ③ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合は、②と同様に選定する。
 472 ④ SPARC による pKa の推定値を選定する。

473

474 4.8 1-オクタノールと水との間の分配係数（log Pow、log Kow と呼ぶ場合もある。）

475 使用可否基準

476 表 1 の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。
 477 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
 478 のデータを暫定的に使用する。

479

480 キースタディ選定ルール

481 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。
 482 ① 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性が高いデータが 1 つであれば、
 483 それを選定する。
 484 ② 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合は、「 $-2.0 < \log Pow \leq 4.0$ 」¹⁹の
 485 ときはフラスコ振とう法、「 $4.0 < \log Pow \leq 6.0$ 」²⁰のときは HPLC 法による値を優先す
 486 る。

487 データが複数ある場合：算術平均値を求め、算術平均値の算出に用いた各データが算
 488 術平均値±1.0 以内²¹である場合は算術平均値に最も近い測定値を選定する。算術
 489 平均値±1.0 を超えるデータがある場合は、そのデータを除いた残りのデータの算
 490 術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選定する。なお、データが 2 つの場
 491 合においてはキースタディを 1 つに絞り込むことはできない。この場合には、2 つ
 492 のデータをキースタディとし、化学物質の log Pow としては 2 つのデータの算術平
 493 均値を選定する。

- 494 ③ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合、②と同様に選定する。
 495 ④ KOWWIN (EPI Suite) による log Pow の推定値を選定する。

496

497 4.9 生分解性

¹⁸ REACH の技術ガイダンスでの測定値の変動係数±0.1 を参考に設定。

¹⁹ OECD TG 107 及び JIS K 7260-107 に示されている適用範囲に基づき設定。

²⁰ OECD TG 117 及び JIS K 7260-117 に示されている適用範囲に基づき設定。

²¹ REACH の技術ガイダンスでの測定値の併行精度±0.1～±0.3 を参考に設定。

498 **使用可否基準**

499 表 1 の信頼性ランク「1」又は「2A、2B（2Cは除く）」に該当する次の条件に合致
 500 するデータをスクリーニング評価等に利用可能なデータの候補とする。

- 501 • 化審法の判定に使われたデータ
- 502 • 化審法の試験法通知等に準じた試験法による試験データ
- 503 • OECD テストガイドライン301「Ready Biodegradability（易生分解性）」シリーズ及び310
 「Ready Biodegradability – CO₂ in sealed vessels (Headspace Test)（易生分解性-密閉容器中
 のCO₂（ヘッドスペース試験））」に準拠した試験結果
- 504 • 「信頼性が高いと認められる情報源」（3 参照）からの測定データ
 データは、被験物質についての直接分析を実施し分解率を明らかにしていること、及
 び分解生成物を同定していることを前提とする。また、OECD テストガイドライン 302C
 単独での情報は生分解性の情報として利用しない。類似物質の情報を元に判定可能な物
 質がある場合も、スクリーニング評価等に利用可能なデータの候補とする。
- 505 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
 のデータを暫定的に使用する。この場合においても、分解率を明らかにしていること、及
 び、分解生成物を同定していることが前提となる。

514

515 **キースタディ選定ルール**

516 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。

- 517 ① 化審法において当該化学物質又は類似物質の生分解性データに基づき判定がなされて
 いる場合はそれを選定する。
- 518 ② 信頼性ランク「1」のデータのうち、化審法の試験法通知等に準じた試験法による試
 験データに該当するデータがあれば、それを選定する。
- 519 ③ 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性の高いデータが 1 つであれば、
 それを選定する。
- 520 ④ 信頼性ランク「1」又は「2」に該当する最も信頼性の高いデータが複数ある場合は
 審議会の判断とする。

525

526 良分解性の判断について

527 化審法における判定を経ていない物質の場合は、審議会等での判断を経ることを原則と
 528 する。特に、スクリーニング評価等で「良分解性」として扱う物質についてはあらかじめ
 529 審議会等において分解性判断を経ることとする。表 3 に示す 1 つ以上の方法でそれぞれの
 530 パスレベルを超える結果が得られた場合には審議会等において「生分解性」判断を行った
 531 めの資料として提出する。

532

533

534 表3 OECD テストガイドライン 301・310 におけるパスレベル

| 試験法 | 301A | 301B | 301C | 301D | 301E | 301F | 310 |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | DOC ダイア ウェイ法 | 修正 Strum 法 | 修正 MITI 法 (I) | クローズド ボトル法 | 修正 OECD スクリーニ ング法 | マノメーター 呼吸測定法 | ヘッドス ペース試験 |
| 生分解性 指標 | DOC 除去率 | CO ₂ 発生率 | BOD 除去率 | BOD 除去率 | DOC 除去率 | BOD 除去率 | ThIC 発生率 |
| 試験期間 | 28 日間 | 28 日間 | 28 日間 | 28 日間 | 28 日間 | 28 日間 | 28 日間 |
| パス レベル | ≥70% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥70% | ≥60% | ≥60% |

535

536 4.10 生物濃縮性(BCF)

537 **使用可否基準**

538 表1の信頼性ランク「1」又は「2」に該当する定量的データを選択する。

539 信頼性ランク「1」又は「2」に該当するデータがない場合に限り、信頼性ランク「4」
540 のデータを暫定的に使用する。

541

542 **キースタディ選定ルール**

543 使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選定する。

- 544 ① 化審法の濃縮度試験による生物濃縮性の判定に用いたデータがあればそれを選定する。
545 その際に定常状態の値を優先する。利用可能な値が複数得られる場合は最も倍率の高
546 いものを用いる。定常状態の値が得られない場合は、各濃度区における後半3回の算
547 術平均濃縮倍率のうち最も倍率の高いものを用いる。「高濃縮性でない」ことが類推に
548 より判定されている場合はその類推物質の BCF を用いる。複数の物質から類推されて
549 いる場合は最大値を用いる。
- 550 ② 化審法の濃縮度試験による生物濃縮性の判定に用いたデータがない場合、信頼性ラン
551 ク「1」又は「2」に該当する最も信頼性の高いデータが1つであれば、それを選定
552 する。
- 553 ③ 信頼性ランク「1」に該当するデータが複数ある場合は、その中の最大値を選定する。
- 554 ④ 信頼性ランク「2」に該当するデータが複数ある場合は、その中の最大値を選定する。
- 555 ⑤ BCF 測定値がなく、分子量が800以上（ハロゲン元素を2個以上含む化合物にあっては分子量1000以上）の場合、logBCF に一律2.0を用いる。なお、この場合、信頼性ランクは「2C」相当とする。
- 558 ⑥ BCF 測定値がなく分子量800未満（ハロゲン元素を2個以上含む化合物にあっては分子量1000未満）の場合、以下の⑥-1、⑥-2と⑤-3により選定する（優先度：（高）⑥-1 > ⑥-2 > ⑥-3（低））。このとき、キースタディ選定ルールに基づき決定されたlogPowの値を用いる。
559 なお、log BCFの計算結果が0.5以下になった場合は一律0.5を用いる。
- 560 ⑥-1 分配係数の試験結果により化審法に基づく生物濃縮性の判定が行われている場合
561 （log Powが3.5未満）

565 対象物質が脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びそのハロゲン化物等（カテゴリー
 566 I「単純受動拡散カテゴリー」及びカテゴリーII-A「水素結合アクセプターによる双
 567 極子-双極子相互作用が受動拡散に影響を与える物質群」に分類されるものに限る。）
 568 の場合は（式1）²²を用いる。

569 $\log BCF = 1.05 \times \log Pow - 1.71$ （式1）

570

571 それ以外の物質の場合は BCFBAFWIN (EPI Suite)、濃縮性予測システム(CERI モ
 572 デル)及び BCF base-line model(OASIS Catalogic) の 3 つの QSAR モデルによる推定値の算術
 573 平均値を用いる。

574

575 ⑥-2 分配係数の試験結果により化審法に基づく生物濃縮性の判定が行われていない場合
 576 であって log Pow が 6.0 未満の場合

577 対象物質が脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びそのハロゲン化物等（カテゴリー I
 578 「単純受動拡散カテゴリー」及びカテゴリーII-A「水素結合アクセプターによる双極
 579 子-双極子相互作用が受動拡散に影響を与える物質群」に分類されるものに限る。）で
 580 log Pow が測定値の場合は上記（式1）を用いる。log Pow が推定値の場合は（式2）²⁰
 581 を用いる。

582 $\log BCF = 1.03 \times \log Pow - 1.48$ （式2）

583

584 それ以外の物質の場合は BCFBAFWIN (EPI Suite)、濃縮性予測システム(CERI モ
 585 デル)及び BCF base-line model(OASIS Catalogic) の 3 つの QSAR モデルによる推定
 586 値の算術平均値を用いる。

587

588 ⑥-3 log Pow が 6.0 以上の場合

589 BCFBAFWIN (EPI Suite)、性濃縮性予測システム(CERI モデル)及び BCF base-line
 590 model(OASIS Catalogic) の 3 つの QSAR モデルによる推定値の算術平均値を用いる。

591

592 5. スクリーニング評価・リスク評価における性状データ選定の全体像

593 性状データの選定について、リスク評価(一次)評価 II 以降における精査等も含めた概念
 594 的全体像を図 2 に示す。


595 本基準は、図の上段のスクリーニング評価等までの段階において用い、そこで選定され
 596 たデータの信頼性ランク等に応じて、リスク評価(一次)評価 II 以降に精査等を行うことを
 597 想定している。

598

²² NITE の構造活性相関委員会による「カテゴリー アプローチによる生物濃縮性予測に関する報告書（カテゴリー I）」（平成 21 年 10 月 20 日）及び「カテゴリー アプローチによる生物濃縮性予測に関する報告書（カテゴリー II-A）」（平成 22 年 12 月 14 日）からの引用。

599

600

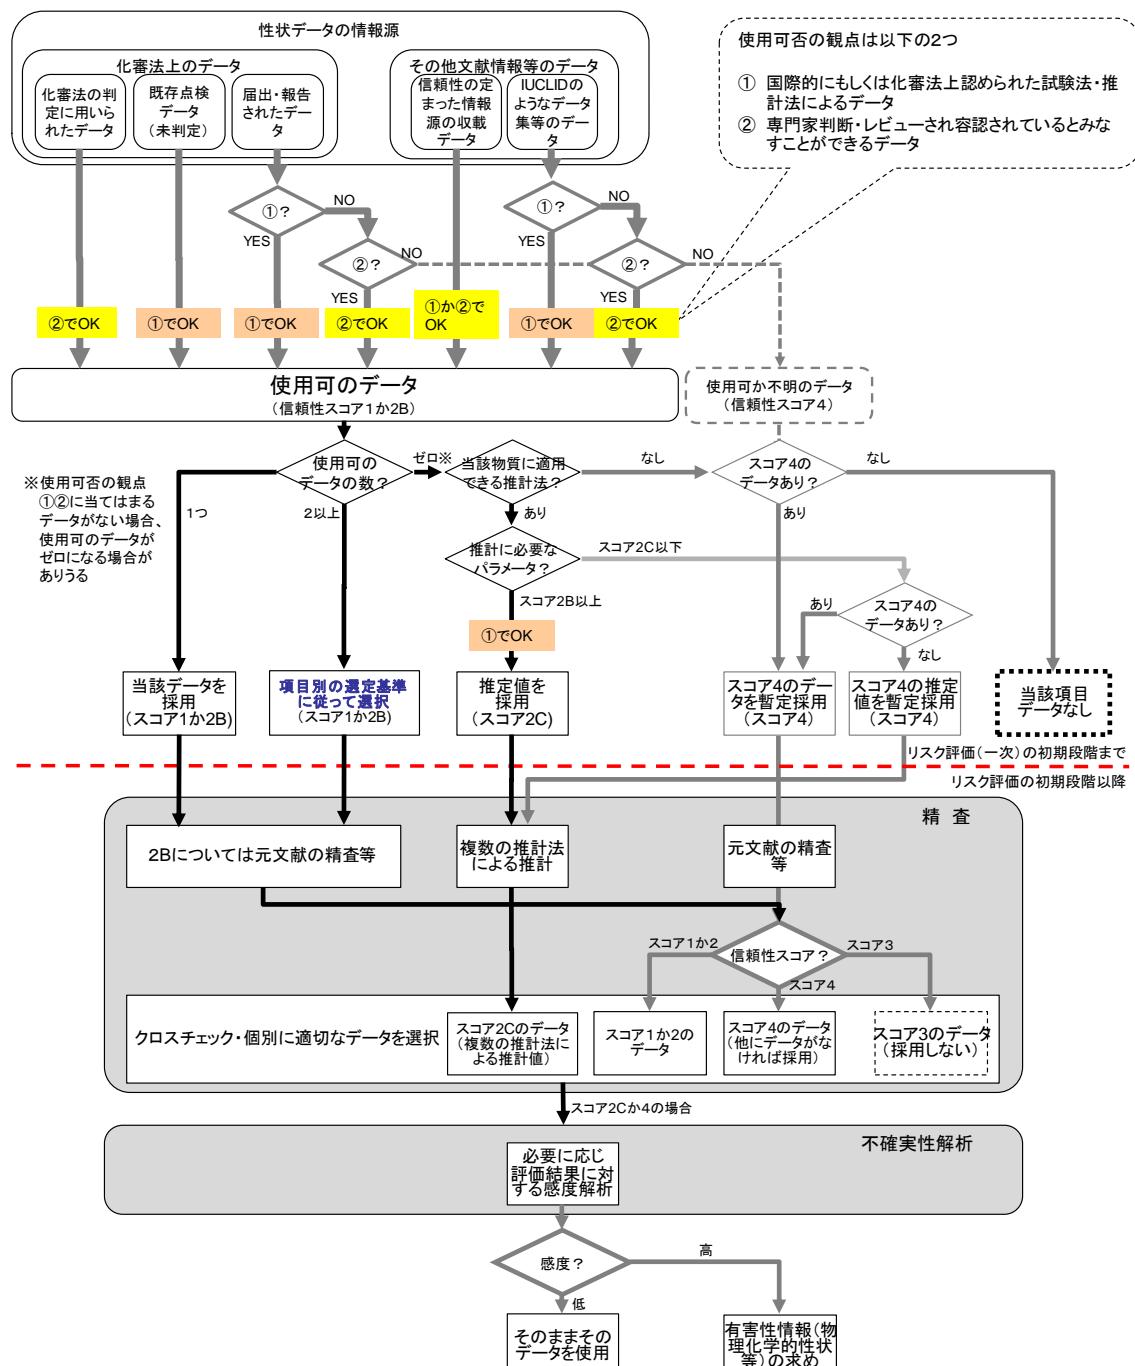

601

602

603

図2 性状データ選定の概念的全体像

604

605

606

607 **6. 国が既知見を収集する情報源の範囲**

608 物理化学的性状・生分解性・生物濃縮性データに関して、国が既知見を収集する情報源
609 の範囲は原則、「3. 信頼性が定まった情報源」とする。

610 なお、上記以外の情報源による既知見を国が入手した場合は1.～4.に則った基準に
611 より評価に用いるデータの選定を行う。

612

613

614 (参考 1)

615 「OECD-HPV 化学物質点検マニュアル」での信頼性の考え方

616

617 Klimisch らによる信頼性評価基準は、信頼性のないデータを取り除くため試験報告書の初期スクリーニングを支援する目的で Klimisch らにより開発された代表的なデータの信頼性を評価するための基準である。本基準は、生態毒性試験と健康への影響試験について信頼性をランク化する方法を導入しており、各ランクは以下の通り、ランク番号が小さいもの程信頼性が高く、信頼性ランク 1 または 2 と評価されるデータが採用できるものとしている。

623 信頼性ランク 4 に該当する二次文献・資料については、元文献・情報が信頼性ランク 1
624 又は 2 である可能性を排除できないが、本選定方法においては原則として元文献・情報に
625 遷及することなく二次文献・資料で判断する。なお、リスク評価(一次)評価 II 以降において元文献・
626 情報の精査を排除するものではなく、この段階において、必要に応じて元文献・
627 情報の信頼性評価を行うものとする。

628

629 ○信頼性ランク 1

630 「Reliable without restriction (信頼性あり (制限なし))」

631 妥当性が確認されたまたは国際的に認められたテストガイドライン (GLP が望ましい)
632 に従って実施された試験又はデータ、又は記載された試験項目が特定の (国レベルの) テ
633 ストガイドラインに基づいているもの、又は記載されたすべての試験項目がテストガイド
634 ラインと密接に関連しているか同等である試験又はデータ。

635

636 ○信頼性ランク 2

637 「Reliable with restrictions (信頼性あり (制限付き))」

638 記載された試験項目は、特定のテストガイドラインと完全には一致していないが、当該
639 データは十分許容されるもの、又は記載項目はテストガイドラインに含めることはではな
640 いが、詳細な記述がなされており科学的に許容される (ほとんどのものは GLP に従っては
641 いない) 試験又はデータ。

642

643 ○信頼性ランク 3

644 「Not reliable (信頼性なし)」

645 測定系と試験物質の間に干渉が生じていたり、用いた生物/試験系への暴露が妥当ではな
646 かったり (例えば、非生理的な投与経路)、許容できない方法に従って実施、又は作られ、
647 記載が評価するには不十分であったり、専門家が判断する上でも説得力がない試験及びデ
648 ータ。

649

650 ○信頼性ランク 4

651 「Not assignable (評価不能)」

652 実験の詳細が十分に示されておらず、短い要約又は二次文献・資料（書籍、レビュー等）

653 に羅列されているだけの試験及びデータ。

654

655 出典：

656 Klimisch, H.J., Andreae, E. and Tillmann, U. (1997) A systematic approach for evaluating the quality of

657 experimental and ecotoxicological data. Reg. Tox. Pharm., 25, 1-5.

658

659 (参考 2)

660 「Japan チャレンジスピンサーマニュアル」での信頼性ランク分類の目安

661

662 1. 既存情報に関する信頼性評価の事例

663 国の既存点検結果については、確立した試験方法で適切に実施されていますので、信頼
664 性評価の必要はありません。このため、ここでは信頼性評価の対象となる既存の文献情報
665 と、自社データのそれぞれについて、使用可能性があるか、無いかの判断の事例を説明し
666 ます。信頼性評価の基準には、科学的に説明可能なものとして専門家が見て容認できるか
667 どうかといった、専門的な判断を必要とする場合があります。各情報収集項目に対応した
668 政府事務局の相談窓口が、必要な助言（必要に応じて専門家の紹介や打ち合わせ日程の設
669 定等を含む）を行いますのでご相談ください。

670 (1) 使用可能性がある情報

671 Japan チャレンジプログラムにおいて使用可能と考えられる文献情報は、以下の通りです。

- 672 • 元文献を入手した結果、当該試験が国際的に認められたテストガイドラインに従い、GLP
673 で実施された試験報告であった場合（OECD 信頼性ランク 1 に該当）
- 674 • 元文献を入手した結果、当該試験が国際的に認められたテストガイドラインに準じて実
675 施された試験報告であって、様式（テンプレート）に十分な情報が記載できるとともに、
676 テストガイドラインからの逸脱について説明可能なもの。（OECD 信頼性ランク 2 に該当）
- 677 • 信頼性の定まったデータベース（メルクインデックス等）に収録されているデータ（OECD
678 信頼性ランク 2 に該当）
- 679 • 科学的に説明可能なもの（専門家の判断用として容認できる研究又はデータ）

680 また、自社データについても、以下のとおり文献情報と同じような考え方で評価が出来
681 ます。

- 682 • 国際的に認められたテストガイドラインに従い、GLP で実施された試験報告。（OECD 信
683 頼性ランク 1 に該当）
- 684 • 国際的に認められたテストガイドラインに準じて実施された試験報告であって、様式に
685 十分な情報が記載できるとともに、テストガイドラインからの逸脱について説明可能な
686 もの。（OECD 信頼性ランク 2 に該当）
- 687 • 雑誌等に投稿されて公表された試験報告であって、様式（テンプレート）に十分な情報
688 が記載できるとともに、テストガイドラインからの逸脱について説明可能なもの。（OECD
689 信頼性ランク 2 に該当）
- 690 • 科学的に説明可能なもの（専門家の判断用として容認できる研究又はデータ）

691

692 (2) 使用可能性のない情報

693 使用可能性のない情報は以下の通りです。

- 694 • 上記（1）以外の試験報告(OECD信頼性ランク 3 に該当、例：不適切な実験方法で実

695 施された実験結果、評価のための記載が不十分な報告、実験結果の解釈に確実性を欠
696 くデータ)

697 ・評価できないもの（OECD 信頼性ランク 4 に該当、例：MSDS 等）

698

699 2. 信頼性が高いと認められる情報源

700 ここでは、信頼性の高いと認められる情報源について説明します。これら情報源に収載
701 されている情報については、原則として原文献又は元データの信頼性評価を要さないと考
702 えられますが、試験の実施時期が相当古いなど、特殊なケースでは、これらの情報源から
703 のデータでも信頼性の評価が必要な場合もあり得ますので、適宜信頼性評価窓口にご相談
704 ください。

705

706 （1）OECD-HPV化学物質点検マニュアルに記載されているもの²³

707 OECD-HPV化学物質点検マニュアルに記載されている信頼性の高いと認められる情報源
708 は以下のとおりです。

- 709 • The Merck Index – (物理化学的性状)
- 710 • Hawley's Condensed Chemical Dictionary – (物理化学的性状、用途)
- 711 • Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology – (用途)
- 712 • Patty's Industrial Hygiene and Toxicology – (ヒト健康影響)
- 713 • US EPA IRIS (Integrated Risk Information System) – (ヒト健康影響, NOAELs, RfDs,
714 RfCs and cancer slope factors)
- 715 • ATSDR (The Agency for Toxic Substances and Disease Registry) Toxicological Profiles
716 – (ヒト健康影響、用途、暴露情報)
- 717 • NTP (National Toxicology Program) Study Report – (ヒト健康影響、用途、暴露情
718 報)
- 719 • IARC (International Agency for Research on Cancer) Monographs on the Evaluation of
720 Carcinogenic Risks to Humans – (ヒト健康影響、用途、暴露情報)
- 721 • OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference
722 of Industrial Hygienists), AIHA (American Industrial Hygiene Association) – (労働環
723 境基準とその根拠)

724 その他の物理化学的性状に関する参考書

- 725 • Lide's CRC Handbook of Chemistry and Physics.
- 726 • Beilstein Handbook of Organic Chemistry.
- 727 • SAX's Dangerous Properties of Industrial Materials.
- 728 • Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards.
- 729 • Lange's Handbook of Chemistry.

²³ 原文に基づき修正・加筆した。

- 730 • Fire Protection Guide on Hazardous Materials (NFPA; National Fire Protection
731 Association).
- 732 • Dust Explosions in the Process Industry (R.K. Eckhoff).
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766

767 (参考 3)

768 単位の換算

769

770 算術平均値の算出等を行う場合、単位変換は次式に従う。

771 ① 温度の換算²⁴

$$^{\circ}\text{C} \Leftrightarrow \text{K} : T (\text{K}) = t (\text{ }^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

$$^{\circ}\text{C} \Leftrightarrow ^{\circ}\text{F} : T (\text{ }^{\circ}\text{C}) = 5/9 [t (\text{ }^{\circ}\text{F}) - 32]$$

774 ② 圧力の換算²⁵

$$\text{mmHg} \Leftrightarrow \text{Pa} : 1\text{Torr} (\text{mmHg}) = 1.333 \times 10^2 \text{ Pa}$$

$$\text{気圧} \Leftrightarrow \text{Pa} : 1 \text{ 気圧} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

777 ③ 水に対する溶解度の換算

778 水の比重は 1.000 として計算する。

²⁴ OECD テストガイドライン 102 から引用

²⁵ OECD テストガイドライン 103 から引用 (一部修正)