


FDGを用いたポジトロン断層撮影によるアルツハイマー病の診断 概要図

- ・使用する合成装置および医薬品：住友重工社製FDG合成装置および医薬品FDGスキャン®注
- ・期待される効能、効果：アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症の診断
- ・被験者の適格基準：AD：改訂NICDS-ADRDA FTLTLD：FTLTD臨床診断基準
- ・試験期間：(症例登録期間)2014年8月1日～2018年12月31日 (追跡期間)最終登録より1年間
- ・目標登録数：190例 (AD 150例、FTLTD 40例) ・最終登録数：138例 (AD119例、FTLTD19例)

試験デザイン：多施設共同前向き観察研究

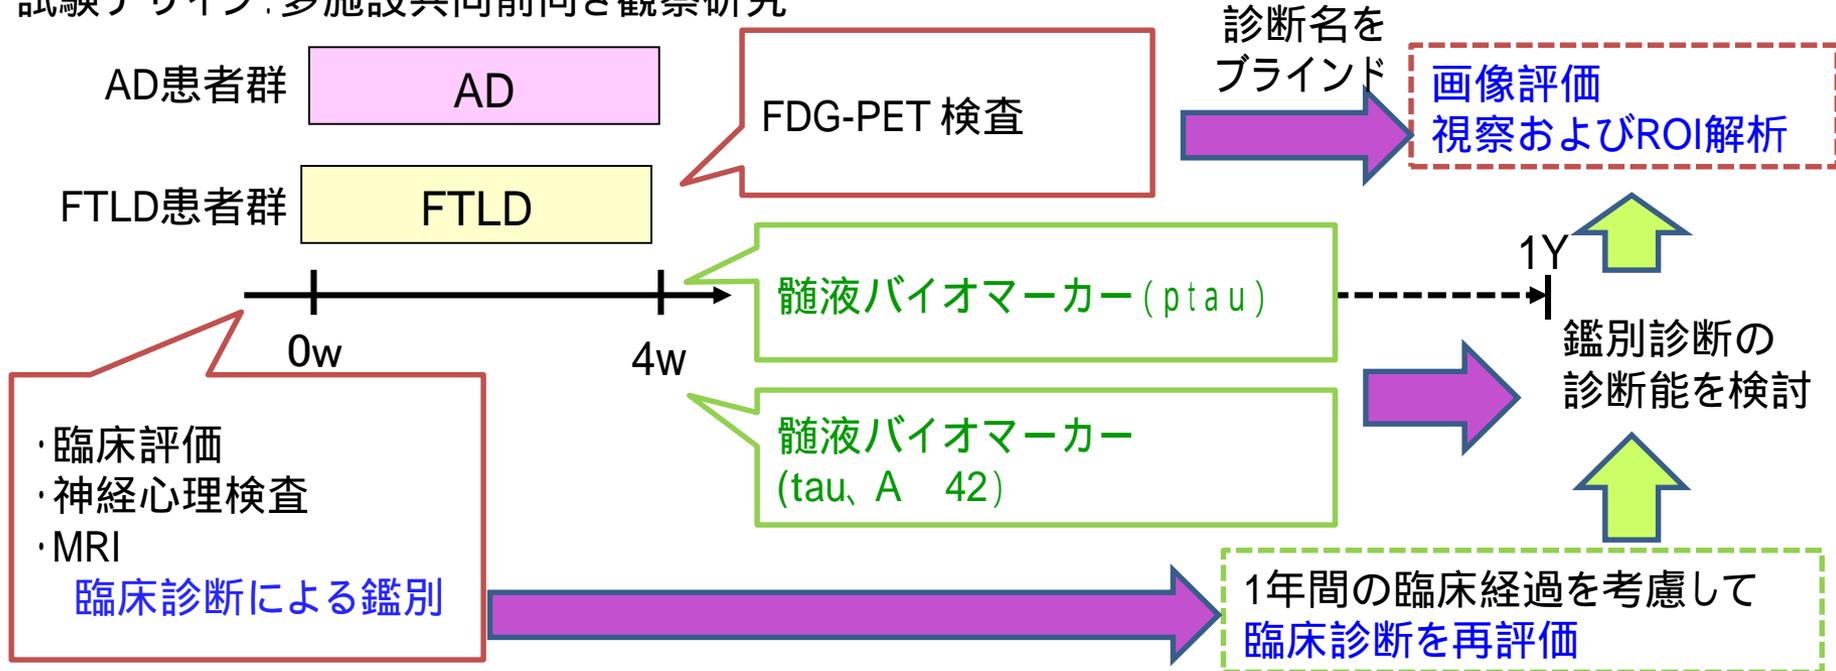

・主要評価：ADとFTLTDの鑑別診断におけるFDG-PETと髄液p-tau181の診断能の差