



絶対

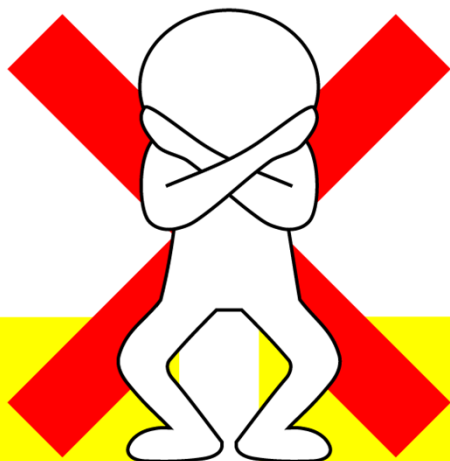

禁止

照射中に
手を入れる

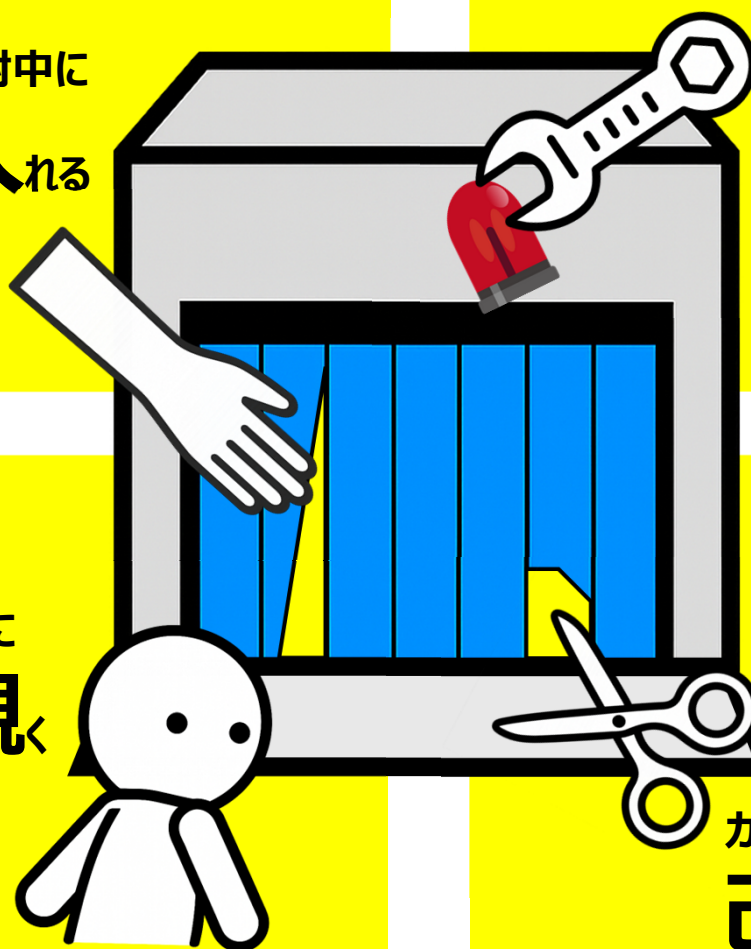

安全装置の
無効化

照射中に
中を覗く

カーテンを切る等の
改造

エックス線装置は正しく使おう！

検査物が詰まったりした場合は、運転停止。異常があれば管理者に連絡を！



ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare



詳しくはこちら
(動画付き)

絶対




禁止

照射中に
手を入れる



安全装置の
無効化

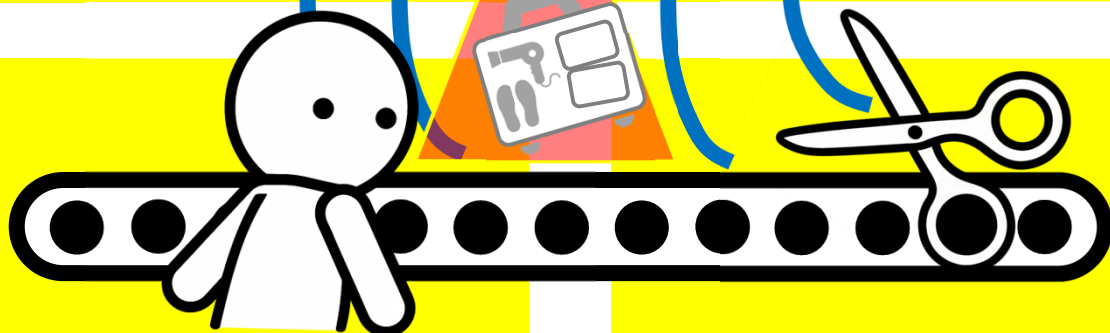

照射中に中を覗く

カーテンを切る等の改造

エックス線装置は正しく使おう！

検査物が詰まったりした場合は、運転停止。異常があれば管理者に連絡を！



ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare



詳しくはこちら
(動画付き)