



絶対

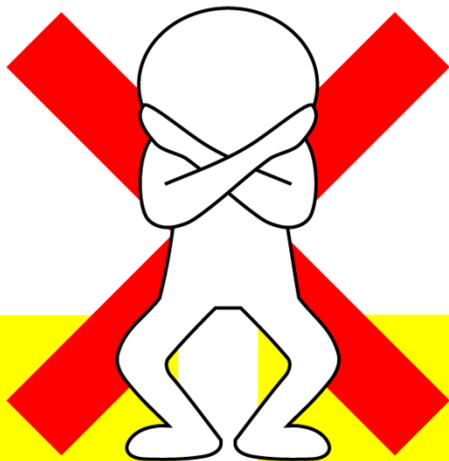

禁止

照射中に
手を入れる

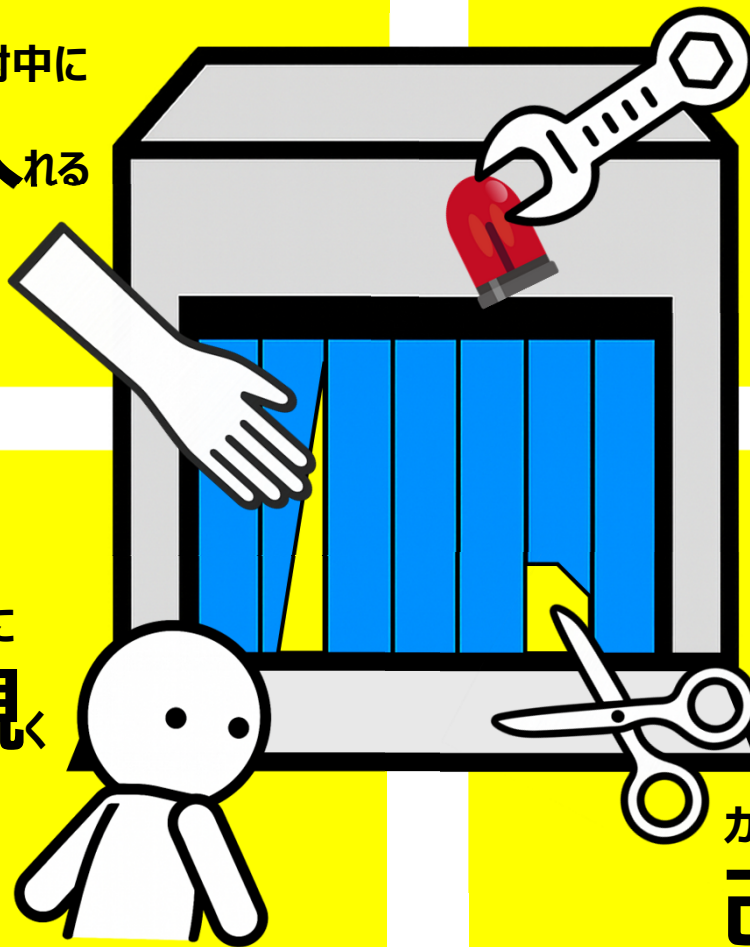

安全装置の
無効化

照射中に
中を覗く


カーテンを切る等の
改造

エックス線装置は正しく使おう！

検査物が詰まったりした場合は、運転停止。異常があれば管理者に連絡を！




絶対

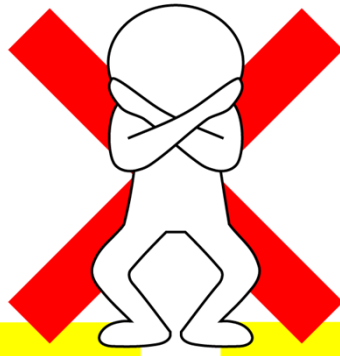


禁止

照射中に
手を入れる

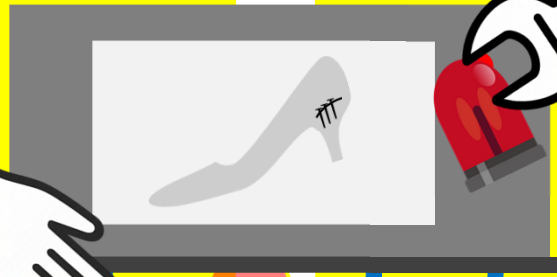

安全装置の
無効化

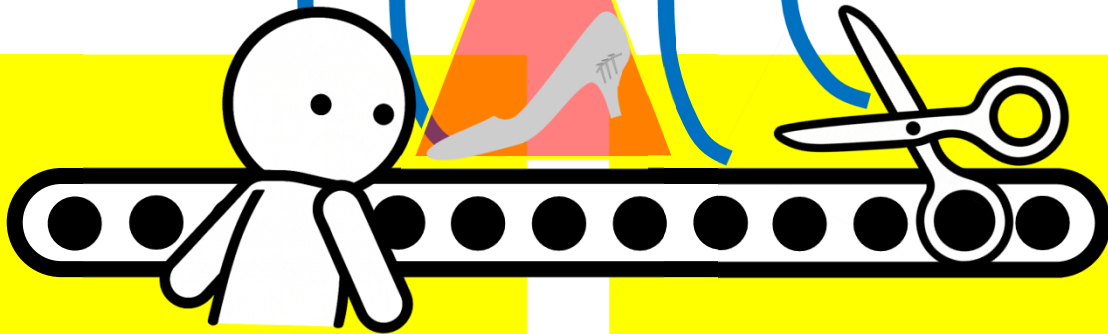

照射中に中を覗く

カーテンを切る等の改造

エックス線装置は正しく使おう！

検査物が詰まったりした場合は、運転停止。異常があれば管理者に連絡を！

