


第75回放射線技師国家試験における
採点除外等の取扱いをした問題について

午前 第 94 問

94 図に標準化間隔 0.1 mm の CR システムを用いてエッジをわずかに傾斜させて計測したプリサンプルド MTF を示す。

この CR システムの 4 cycles/mm のデジタル MTF 値に最も近いのはどれか。

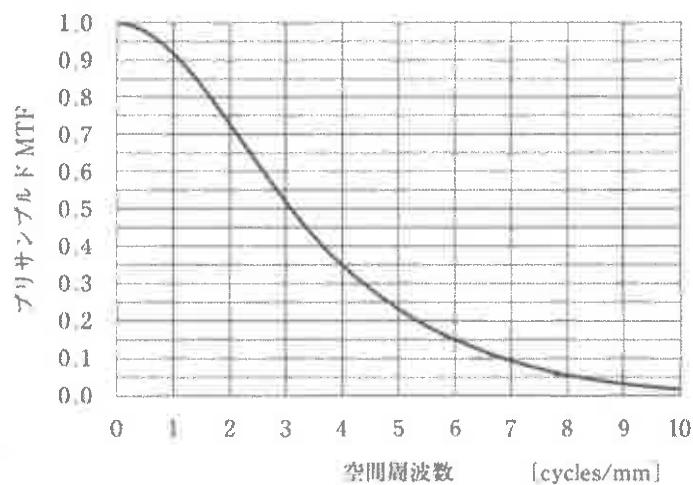

1. 0.15
2. 0.22
3. 0.35
4. 0.46
5. 0.50

(採点上の取り扱い)

複数の選択肢を正解として採点する。

(理 由)

複数の正解があるため。