


AHA 国際ガイドライン 2000 における AED の使用手順

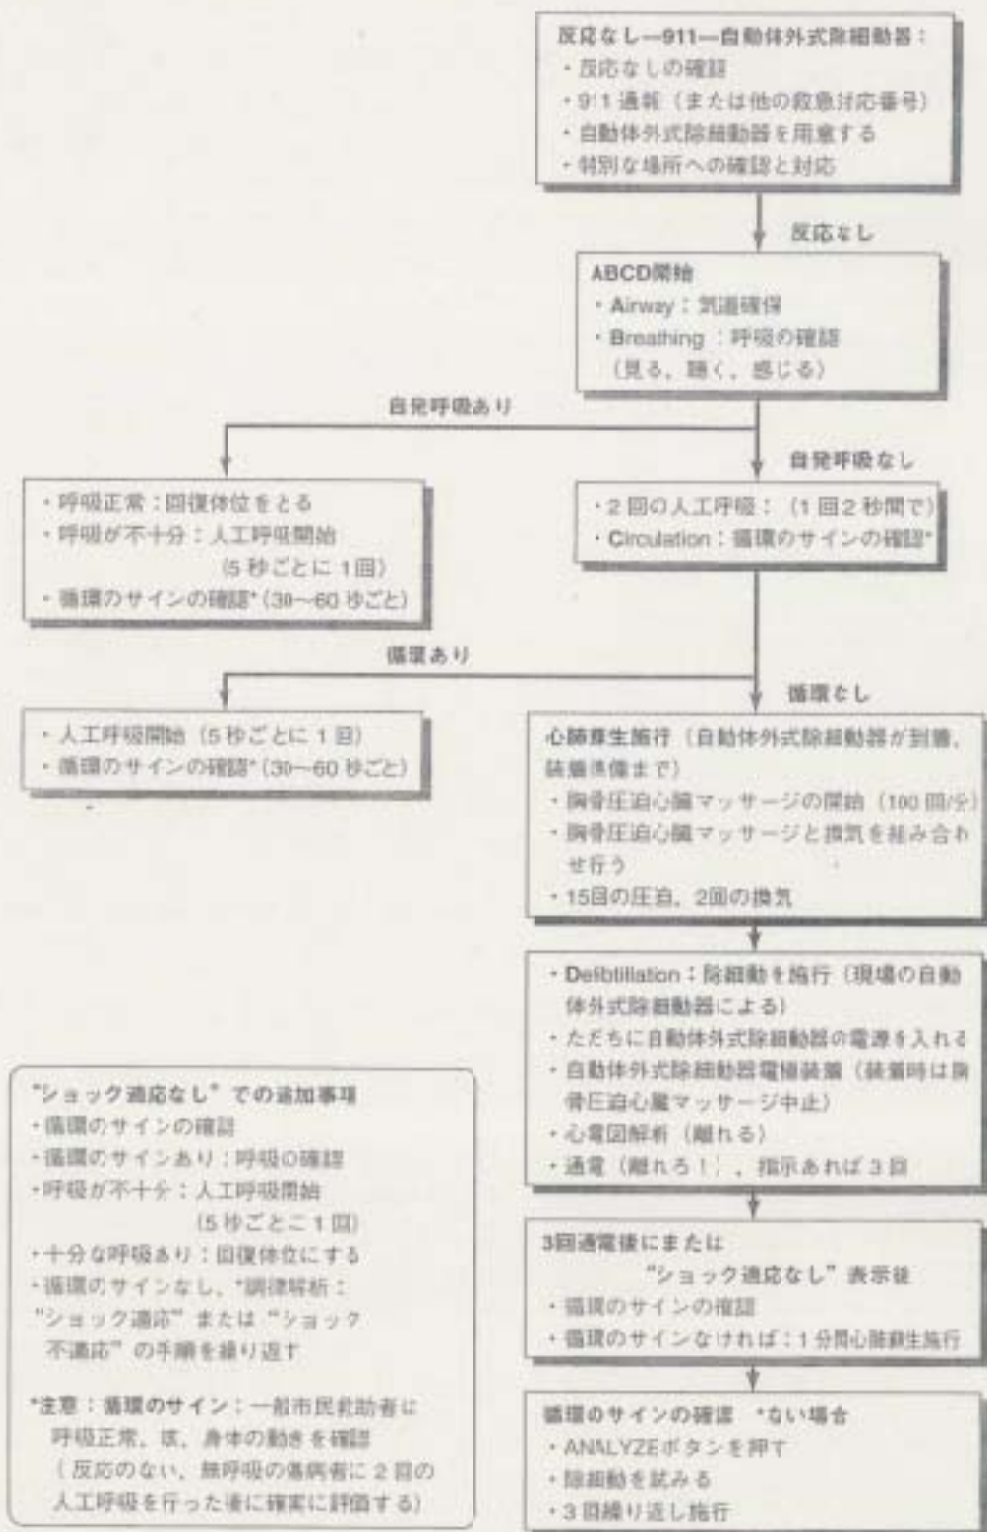

"ショック達成なし"での追加事項

- ・循環のサインの確認
- ・循環のサインあり: 呼吸の確認
- ・呼吸が不十分: 人工呼吸開始 (5秒ごとに1回)
- ・十分な呼吸あり: 回復体位にする
- ・循環のサインなし、"調律解析": "ショック達成"または"ショック不達成"の手順を繰り返す

*注意: 循環のサイン: 一般市民救助者は呼吸正常、または、身体の動きを確認 (反応のない、無呼吸の患者者に2回の人工呼吸を行った後に確実に評価する)

出典: AHA 心肺蘇生と救急心血管治療のための国際ガイドライン 日本語版 (監修: 岡田和夫ほか)