

テレメリー式心電送信機ZS-930Pの電池切れ事例  
(日本光電工業社)

参考資料2-10


電池容量

送信機

セントラルモニタ

電池  
正常状態

3.0V  
∩  
1.8V

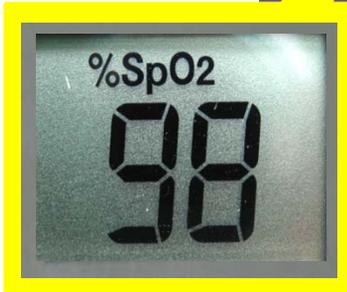

信号




電池  
消耗状態

1.8V  
∩  
1.6V



信号

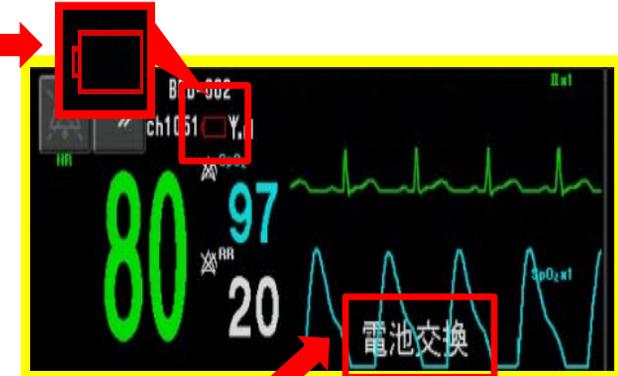

[電池マーク]表示

[電池交換]表示


+ 可聴アラーム  
20秒に1回ポーン

モニタリング  
不可能

1.6V  
∩



信号 ~~X~~

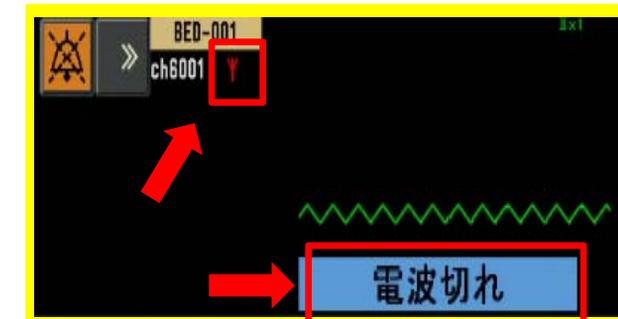

可聴アラーム  
(電池が切れるまで  
ピー——と鳴り続ける)

[電波切れ]表示

+ 可聴アラーム  
20秒に1回ポーン