


# 京都府農林水産技術センターでの検査

検査機器 NaIシンチレーションスペクトロメータ




フードプロセッサでより細かく切断

17

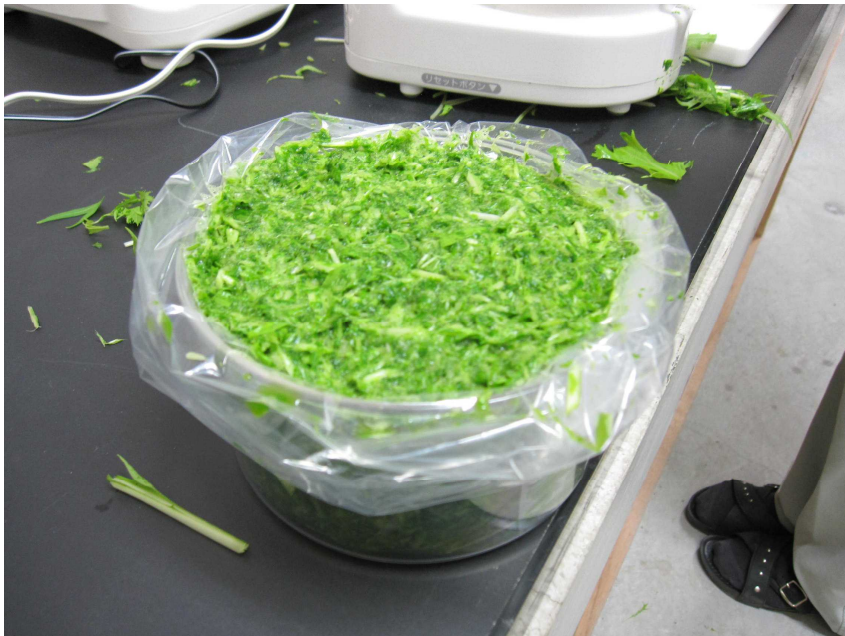

検査用容器に入れる

18

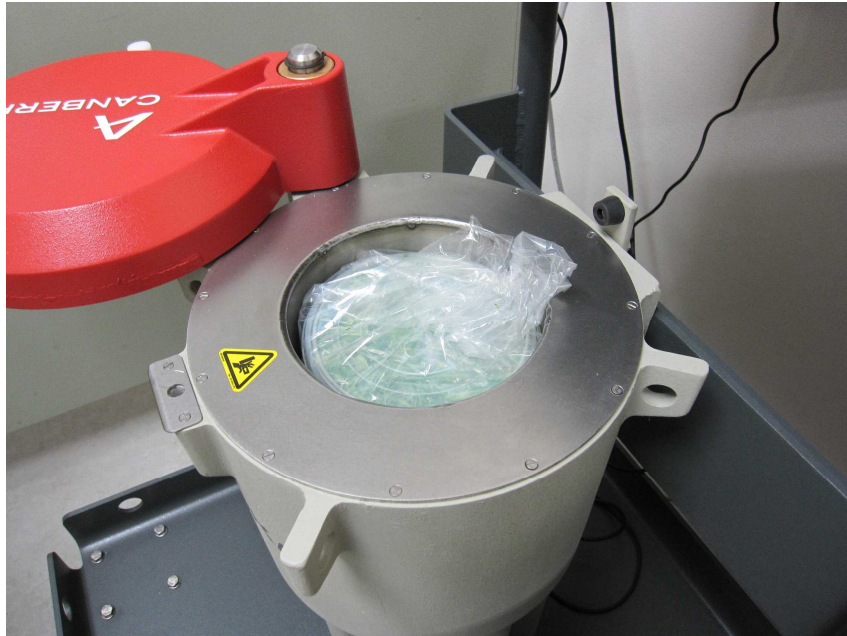

検査機に投入

19



フタをして20～30分間計測

20